

RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN SLEMAN
DI MEDARI SLEMAN

2866

13.675
24.9.79

No. : 579/17 RM/79
Lamp. : 1 bendel.
Hal. : Data² Laboratorium.

Kepada :
Yth. Bapak Ka Kan Wil Dep.Kes.
D.I.Y.
di
Yogyakarta.

Din. Kes. D.I.Y.

Ag. no.	8634/2/19/KS
Tgl.	27-9-79

Dengan hormat.

Berkerjaan dengan surat dari Ka Kan Wil Dep.Kes.D.I.Y. tgl. 16-8-'79 no.01572/I/PKes/79 perihal data² laboratorium Rumah Sakit Umum Kabupaten Sleman bersama ini kami kirimkan data² tersebut.

1. Keadaan ruangan Laboratorium :

- luas : 6 X 7 m²
- Binding tembok dilapisi tegel perselin setinggi 2m.
- Meja kerja dari perselin 3 buah.
- Bak cuci 1 buah, sarana air ada (cukup).
- W.C. dan kamar mandi satu buah. (seket gambar terlampir).

2. Alat² yang ada dan sebagian yang rusak pada daftar terlampir.

3. Reagensia yang ada pada daftar terlampir.

4. Ketenagaan :

- Laborat : 3 orang berpendidikan S.P.K.F.
satu orang laborat tetap RSU (Sdri Lestari)
satu orang tenaga honoraik (ikut ujian Inpres) Sdr Saadi.
satu orang tenaga dari Inpres Puskesmas.

5. Lain² yang dianggap perlu.

a). sampai sekarang masih memerlukan pemeriksaan rutine :

- Urine
- Foices.
- Darah lengkap, dan Maematecret.
- Secrik
- Dahak.

b). Pemeriksaan klinik kimia belum bisa dijalankan karena spectre photometer yang ada belum bisa dipakai (sudah dibetulkan dua kali tapi masih tetap tidak tepat hasilnya bila dicek ke laborat Kesehatan D.I.Y.)

c). Pemeriksaan widal, WR, VDRL, belum bisa dijalankan karena belum mempunyai incubator dan water bat.

d). Data² pemeriksaan th. 1978 terlampir, juga spesiment yang dikirimkan ke laborat Kesehatan D.I.Y.

e). Mohon penjelasan alat² yang belum bisa dipakai dan rusak ini harus dibetulkan dimana.

f). Mohon tenaga² laborat RSU Sleman bisa di up grade untuk pemeriksaan kliniko Kimia.

g). Kekurangan alat² laborat mohon dapat dianggarkan lewat A.P.B.D. Tingkat I

1. Spectre photometer.
2. Water bat.
3. Incubator.
4. Water Destilaties
5. A.C.

Demikian laporan kami terima kasih atas terkabulnya permohonan kami lewat laporan ini.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Ka Sub Dit RS Din Kes D.I.Y.
2. Ka Sub Dit Lab.Kes.Din Kes D.I.Y.
3. Kepala Proyek Pengembangan RSU Kab. D.I.Y.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Sleman.
5. Arsip .-


Sleman tgl, 14 - 9 - 1979.

Kepala Rumah Sakit Umum
Kabupaten Sleman

R. S. SLEMAN

(dr. Soyatmi Awizer)

NIP. 140058837.

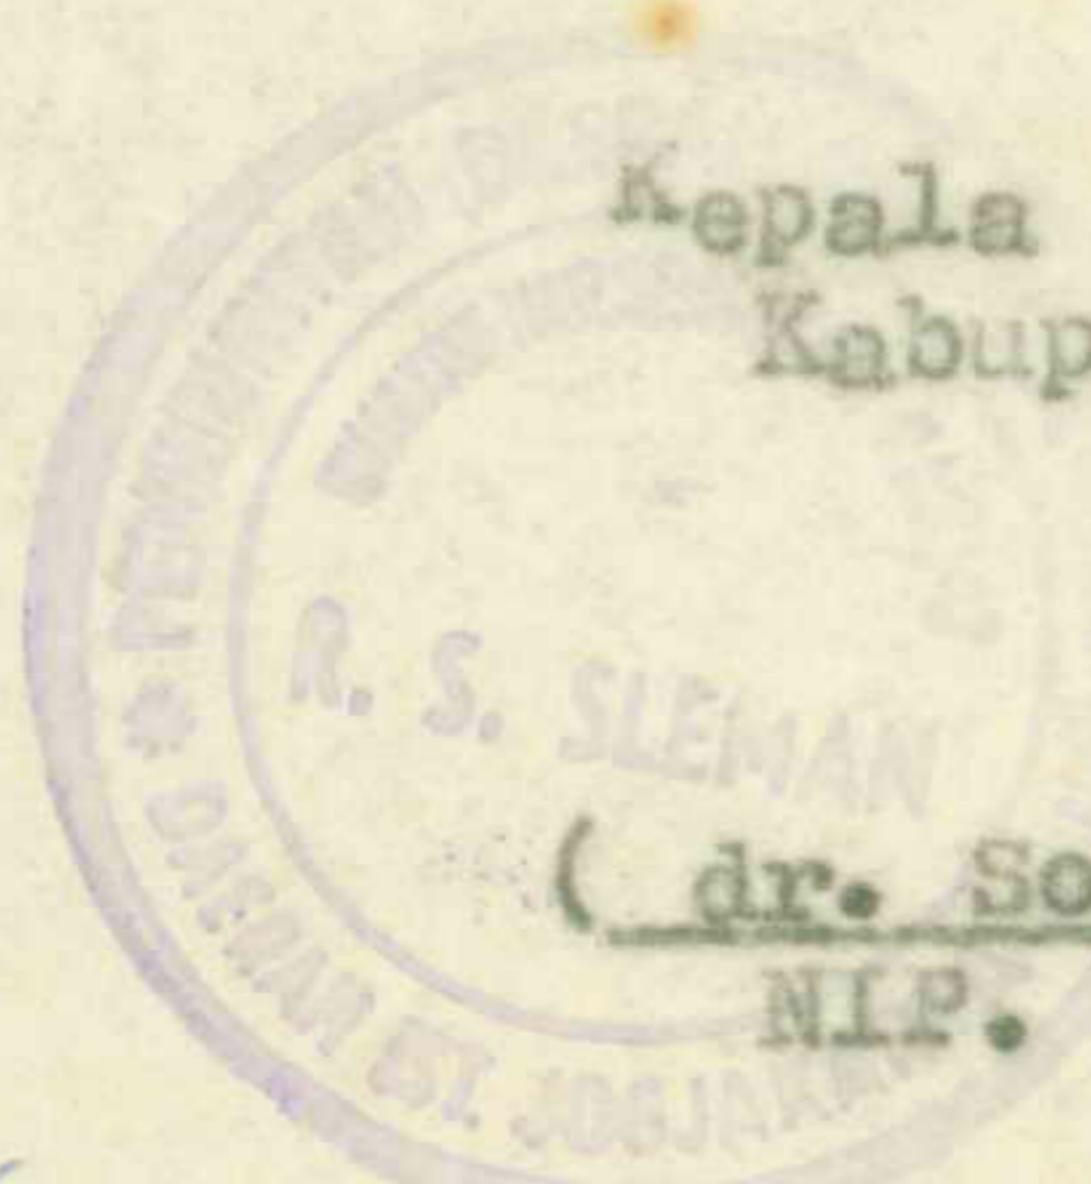

No: 947/RS/79